MAQUET
GETINGE GROUP

HEARTSTRING III
SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ PROXIMALE*
MODE D'EMPLOI SIMPLIFIÉ

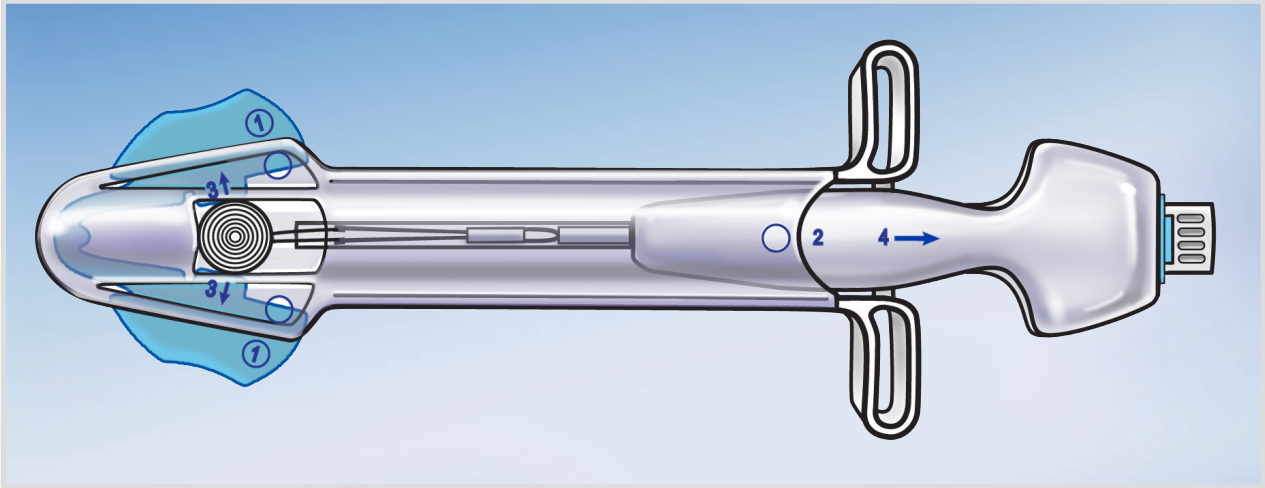

Retirez le système d'étanchéité proximale HEARTSTRING III de son emballage et, pour le charger, suivez la procédure **SMART** en 4 étapes.

S = Serrez | **M** = Maintenez | **A** = Avancez | **R** = Relâchez | **T** = Tirez

Pendant que vous procédez aux différentes étapes du chargement, regardez bien le HEARTSTRING III à travers la fenêtre du système de chargement.

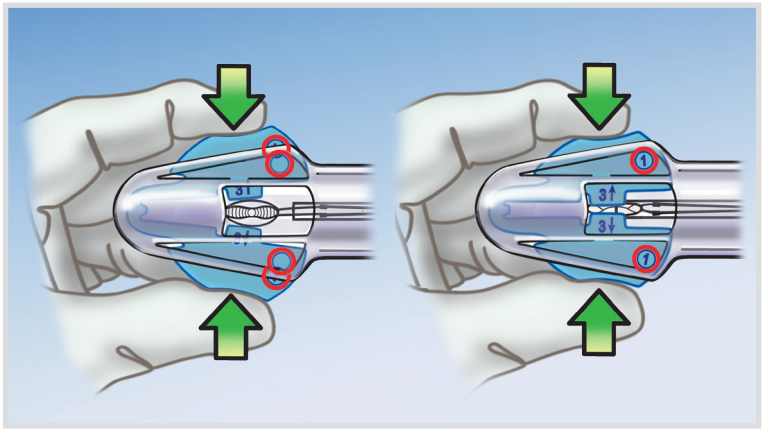

ÉTAPE 1

ÉTAPE 1

Serrez les deux poussoirs bleus du bout des doigts afin que le ① apparaisse dans la fenêtre et **M**aintenez. Vérifier à l'oeil le bon enroulement du HEARTSTRING III.

Maintenir la pression sur les poussoirs bleus jusqu'à la fin de l'étape 2.

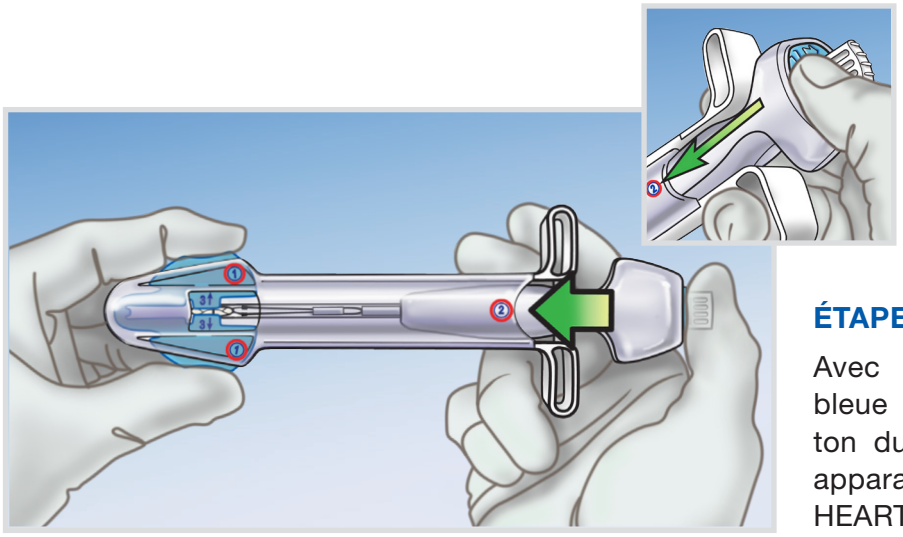

ÉTAPE 2

ÉTAPE 2

Avec le pouce, pressez l'extrémité bleue puis **A**vancez lentement le piston du dispositif de largage jusqu'à voir apparaître dans la fenêtre le chiffre ②sur le HEARTSTRING III enroulé.

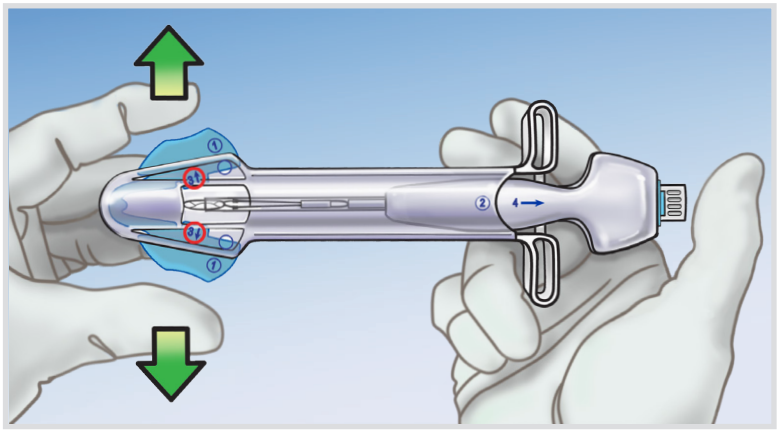

ÉTAPE 3

ÉTAPE 3

Relâchez les poussoirs bleus comme indiqué par les flèches de la fenêtre 3.

Inspectez le chargement correct du HEARTSTRING III dans le tube transparent du système de largage.

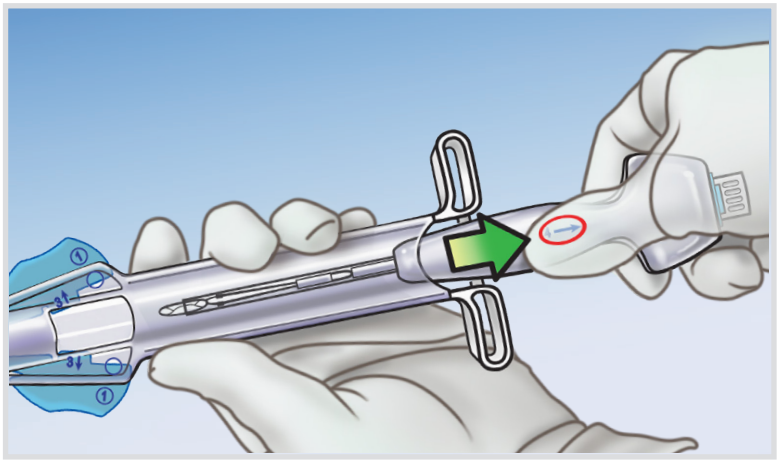

ÉTAPE 4

ÉTAPE 4

Tirez le système de largage hors du chargeur dans la direction indiquée par la flèche 4, tout en tenant fermement le corps du système de chargement.

Durant cette étape, veillez à ne pas tenir le corps du système de chargement par les poussoirs bleus.

MAQUET est une marque déposée par MAQUET GmbH & Co. KG · MCV-BR-7000185-FR-01 · Copyright 2014 MAQUET Cardiovascular LLC ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 02/2014
ATTENTION: aux États-Unis, la législation fédérale autorise la vente, la distribution et l'utilisation dece dispositif uniquement par ou sur ordonnance d'un médecin.